

**Zeitschrift:** Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène  
**Herausgeber:** Bundesamt für Gesundheit  
**Band:** 74 (1983)  
**Heft:** 2

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 15.03.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Dissertationen**  
**Zeitschriften**  
**Bücher**

**Ehrl Druck AG**      **Buchdruckerei**  
**Sarnen**      **Telefon (041) 66 10 33**

Automatisierte und handbediente


**TOBLER-**  
**WASSERFILTER**  
**TOBLER-**  
**DOSIERAUTOMATEN**

zur Aufbereitung von  
Trink- und Industrierwasser

**Jacques Tobler AG, 6010 Kriens**  
**Telefon 041 - 41 76 77**

Leitung:  
K. Tobler, dipl. Ing. chem.. ETH

## Dreissig Thermostaten in einem Gerät

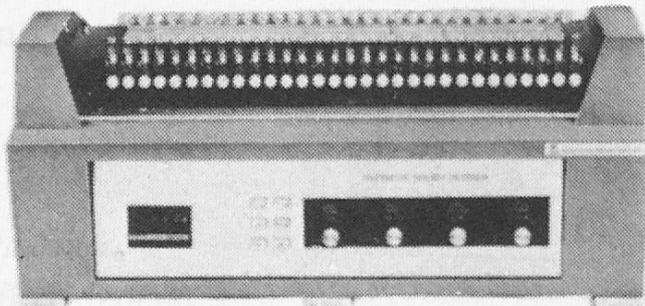

## Temperatur-Gradienten- Schüttler SI

das ideale Gerät für die  
Untersuchung der  
Temperaturabhängigkeit  
chemischer Reaktionen und  
biologischer Vorgänge.

Fermentation – Konservierung

Temperaturbereich beliebig  
einstellbar zwischen  $-5\text{ °C}$  und  
 $+110\text{ °C}$

30 x 2 Arbeitsplätze

Temperatursprung max.  $4\text{ °C}$


**Dr. Bender & Dr. Hobein AG, 8042 Zürich,  
Telefon 01 361 17 77**



**MAGNETRÜHRER  
RÜHRMOTOREN  
ANALYSENSCHLAG-  
MÜHLE  
CALORIMETER**

Ab Lager!

Bitte Prospekte + Preislisten  
anfordern!

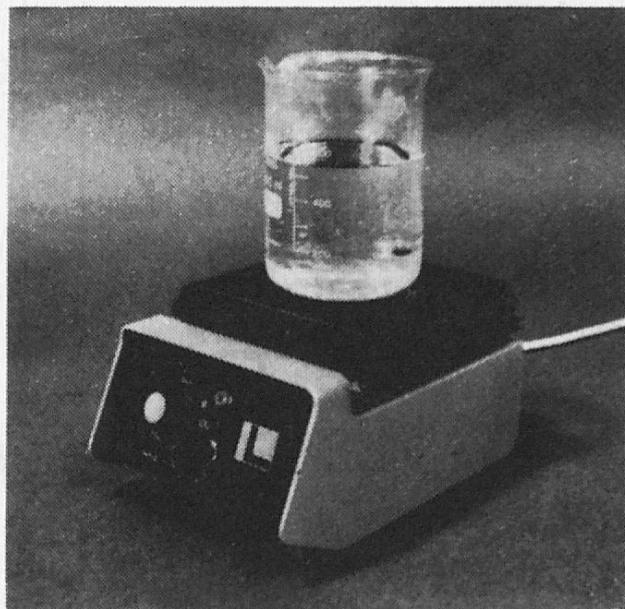

**ingtec ag**

**INGTEC AG RHEINFELDEN  
TELEFON 061-87 23 23  
4310 RHEINFELDEN**