

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Mitteilungen aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung und Hygiene = Travaux de chimie alimentaire et d'hygiène**

Band (Jahr): **74 (1983)**

Heft 2

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Dissertationen
Zeitschriften
Bücher

Ehrl Druck AG **Buchdruckerei**
Sarnen **Telefon (041) 66 10 33**

Automatisierte und handbediente


TOBLER-
WASSERFILTER
TOBLER-
DOSIERAUTOMATEN

zur Aufbereitung von
Trink- und Industrierwasser

Jacques Tobler AG, 6010 Kriens
Telefon 041 - 41 76 77

Leitung:
K. Tobler, dipl. Ing. chem.. ETH

Dreissig Thermostaten in einem Gerät

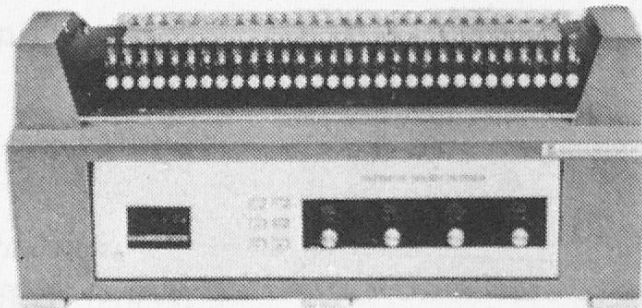

Temperatur-Gradienten- Schüttler SI

das ideale Gerät für die
Untersuchung der
Temperaturabhängigkeit
chemischer Reaktionen und
biologischer Vorgänge.

Fermentation – Konservierung

Temperaturbereich beliebig
einstellbar zwischen $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ und
 $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$

30 x 2 Arbeitsplätze

Temperatursprung max. $4\text{ }^{\circ}\text{C}$


**Dr. Bender & Dr. Hobein AG, 8042 Zürich,
Telefon 01 361 17 77**



**MAGNETRÜHRER
RÜHRMOTOREN
ANALYSENSCHLAG-
MÜHLE
CALORIMETER**

Ab Lager!

Bitte Prospekte + Preislisten
anfordern!

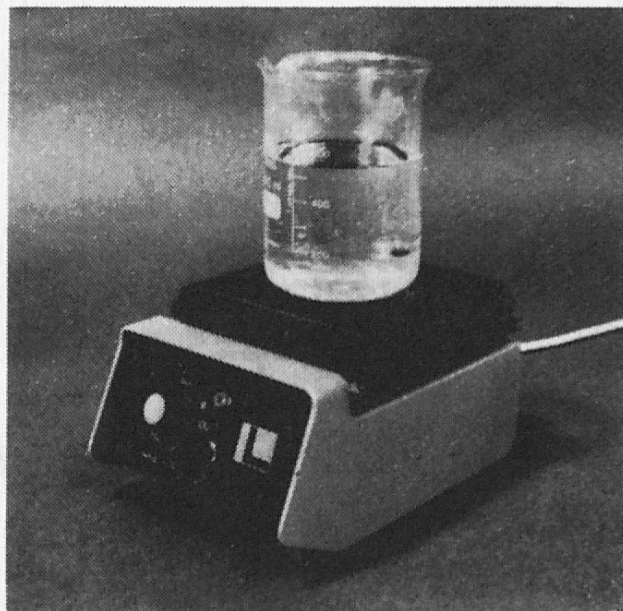

ingtec ag

**INGTEC AG RHEINFELDEN
TELEFON 061-87 23 23
4310 RHEINFELDEN**